

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白


記

■実施日 2019年 10月 7日(月)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
45	9647 3L320	炭酸リチウム(Li)	項目名称	リチウム	炭酸リチウム	より適切な名称(測定物質名)に変更
			検査方法	比色法	原子吸光分析法	測定試薬・検査方法変更に伴う変更。
			有効治療濃度	0.40~1.20mEq/L	0.6~1.2mEq/L	
			報告下限値	0.01mEq/L未満	0.1mEq/L未満	

■従来法との相関

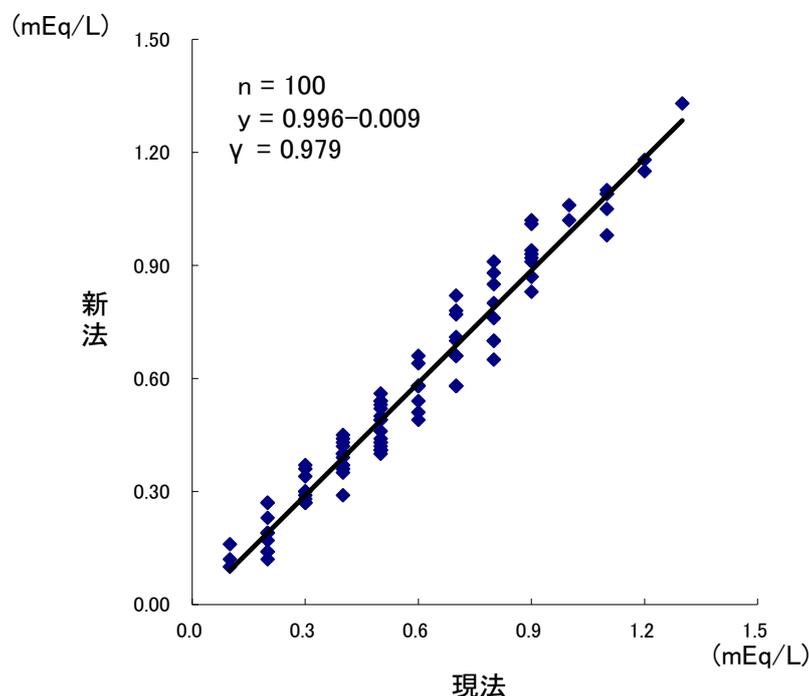

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。