

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白


記

■実施日 2019年 10月 7日（月）ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
45	9647 3L320	炭酸リチウム (Li)	項目名称	リチウム	炭酸リチウム	より適切な名称(測定物質名)に変更
			検査方法	比色法	原子吸光分析法	測定試薬・検査方法 変更に伴う変更
			有効治療濃度	0.40～1.20mEq/L	0.6～1.2mEq/L	
			報告桁数	小数2位	小数1位	
			報告下限値	0.01mEq/L未満	0.1mEq/L未満	

■従来法との相関

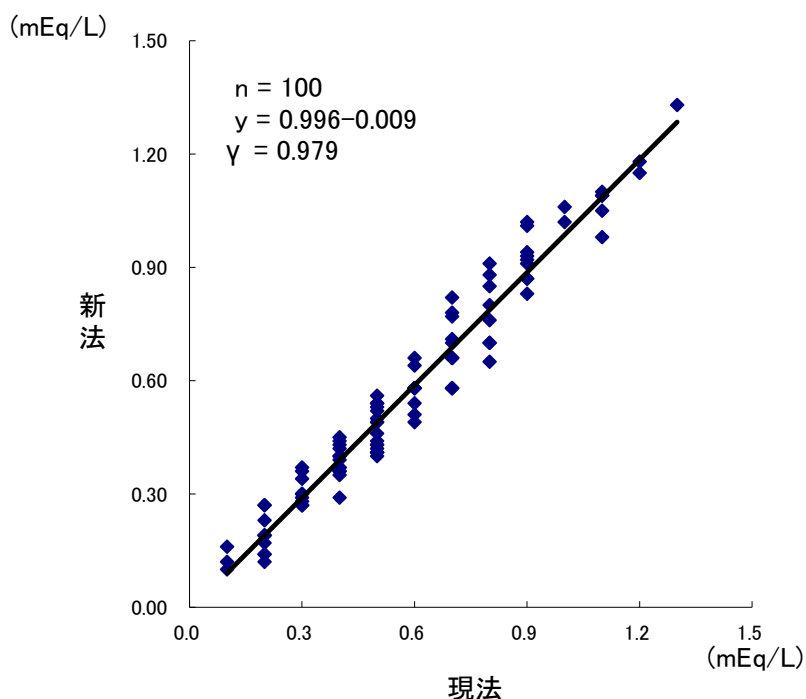

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社お客様窓口までお申し付けください。