

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日 2020年 6月 15日（月）ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	備考
120	9301 5F202	EB抗VCA-IgG[FA]	測定試薬	現行試薬の販売中止に伴い、 別メーカーの試薬へ変更致します。
	9302 5F202	EB抗VCA-IgM[FA]		
	9303 5F202	EB抗VCA-IgA[FA]		
	9304 5F203	EB抗EA-DR IgG[FA]		
	9307 5F204	EB抗EBNA[FA]		


*基準値、検査方法、検体採取量等の変更はございません。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社お客様窓口までお申し付けください。

裏面もご確認下さい

■ 相關


EB抗VCA-IgG

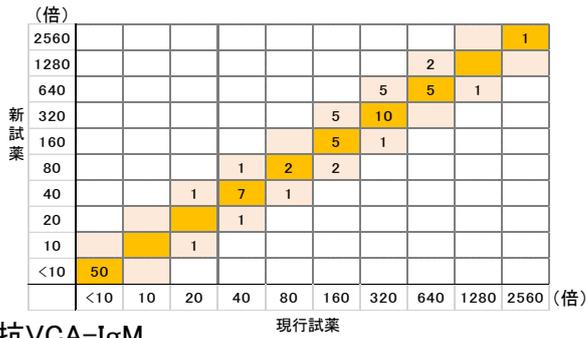

		現行試業		合計
		(+)	(-)	
新試業	(+)	51	0	51
	(-)	0	50	50
合計		51	50	101

陰性 一致率 50例/50例(100%)
陽性 一致率 51例/51例(100%)
全体 一致率 101例/101例(100%)


EB抗VCA-IgM

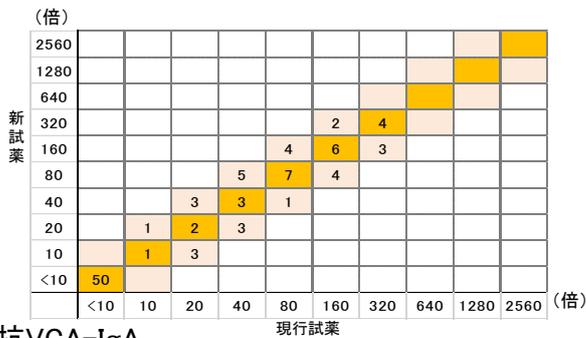

		現行試業		合計
		(+)	(-)	
新試業	(+)	52	0	52
	(-)	0	50	50
合計		52	50	102

陰性 一致率 50例/50例(100%)
陽性 一致率 52例/52例(100%)
全体 一致率 102例/102例(100%)


EB抗VCA-IgA

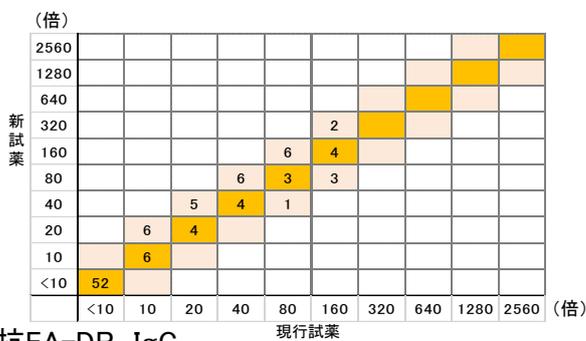

		現行試業		合計
		(+)	(-)	
新試業	(+)	50	0	50
	(-)	0	52	52
合計		50	52	102

陰性 一致率 52例/52例(100%)
陽性 一致率 50例/50例(100%)
全体 一致率 102例/102例(100%)


EB抗EA-DR IgG

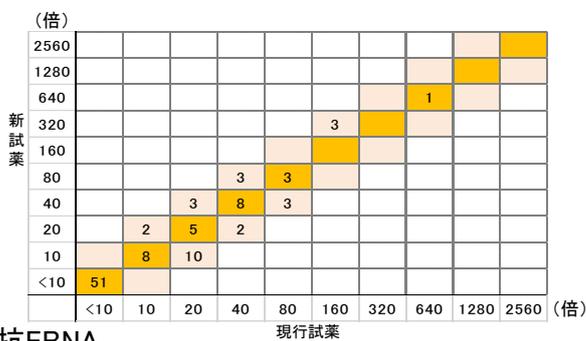

		現行試業		合計
		(+)	(-)	
新試業	(+)	51	0	51
	(-)	0	51	51
合計		51	51	102

陰性 一致率 51例/51例(100%)
陽性 一致率 51例/51例(100%)
全体 一致率 102例/102例(100%)

EB抗EBNA

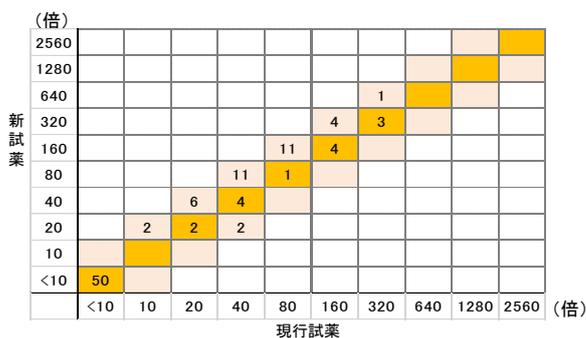

		現行試業		合計
		(+)	(-)	
新試業	(+)	51	0	51
	(-)	0	50	50
合計		51	50	101

陰性 一致率 50例/50例(100%)
陽性 一致率 51例/51例(100%)
全体 一致率 101例/101例(100%)

(メーカー資料引用)