

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白


記

■実施日 2022年 9月 30日（金）ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
89	3421 5G300	TSH刺激性レセプター抗体 (TSAb)	検査方法	バイオアッセイ法	EIA	委託先における測定試薬変更
			必要量	血清 0.4mL	血清 0.5mL	
			基準値	110 % 未満	120 % 以下	
			報告下限	92 % 未満	0 %	
			報告上限	1,200 % 以上	9,990,000 % 以上	
			備考	溶血検体では測定値が低下傾向となる場合があります。血清以外は検査不可。		

■相関

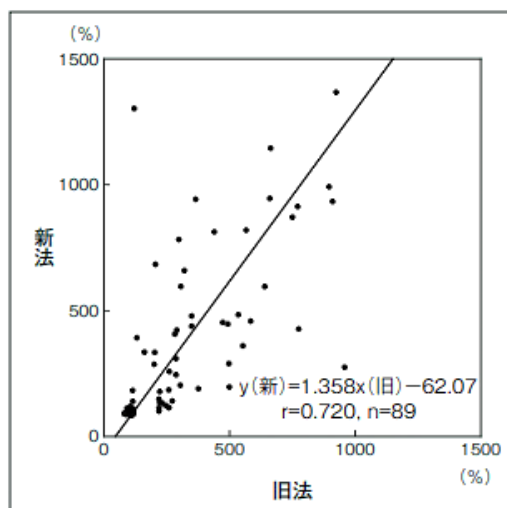

判定一致率

		旧法		計
		陽性	陰性	
新法	陽性	46	6	52
	陰性	1	36	37
計		47	42	89

陽性一致率：97.9% (46/47)

陰性一致率：85.7% (36/42)

判定一致率：92.1% (82/89)


(委託先検討資料より)

裏面もご確認ください

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社お客様窓口までお申し付けください。

[参考情報]

新試薬による正常および各種甲状腺疾患におけるTSAb活性の分布

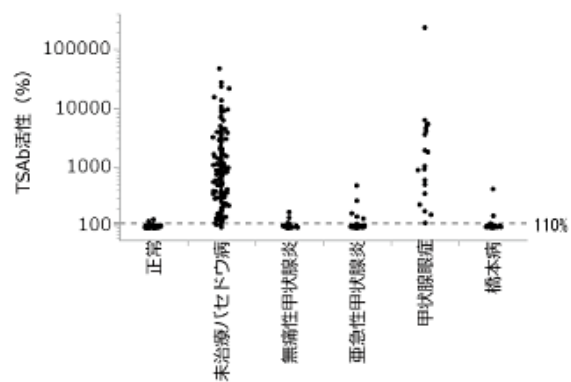

(試薬添付文書引用)